



HPV-test i Danmark Februar 2009

Afdelingsbioanalytiker
Jette Christensen
Patologisk Institut, Aalborg Sygehus

HPV-test i Danmark

- Sundhedsstyrelsen anbefaler HPV-test ved ASCUS og LSIL, 2007
- DSOG anbefaling af HPV-test efter konisering, 2008

HPV-test i Danmark

Sundhedsstyrelsen anbefaler:

Patologiafdelinger, som deltager i undersøgelsen af celleprøver fra livmoderhalsen, bør tage initiativ til, at der foretages HPV-test ved atypiske celler, lette cellerforandringer og ved kontrol efter behandling af dysplasi. Indikationsområdet afhænger af den valgte HPV-test.


HPV-test i Danmark

DSOG anbefaler:

Det må anbefales at udføre HPV test på alle kvinder 6, 12 og 24 mdr. post konus til opsporing af patienter i høj risiko for at udvikle recidiv. Hvis disse tre tests er normale kan patienten overgå til normalt screeningsprogram

HPV-test i Danmark

DSOG anbefaler:

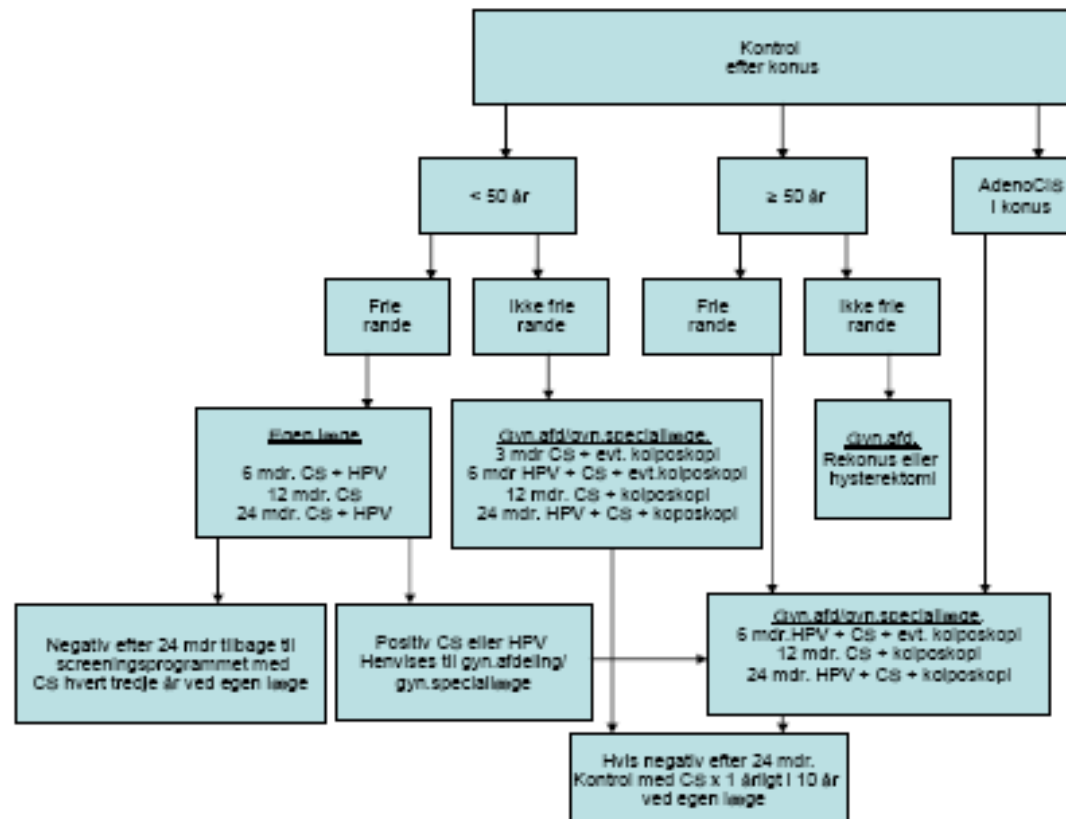

HPV-test i Danmark

Region Hovedstaden

Hvidovre

Hillerød

Herlev

Har plan for HPV-test

HPV-test i Danmark

Region Hovedstaden

Hvidovre og Hillerød

- Anvender tyndtlagsteknik
- DNA-test, Digene Hybrid Capture2 (HC2)
- Kvinder >30 år med ASCUS

HPV-test i Danmark

Region Hovedstaden

Herlev

- Anvender konventionel teknik
- RNA-test, NorChip
- Kvinder med ASCUS eller LSIL og koniserede (fra sygehus afd.)

HPV-test i Danmark

Region Sjælland

Roskilde

Næstved

Slagelse

Har endnu ikke plan for HPV-test

HPV-test i Danmark

Region Sjælland

Roskilde og Næstved

- Anvender konventionel teknik
- Overvejer/anvender i projekt RNA-test, NorChip
- Kvinder med ASCUS eller LSIL og koniserede (1. kontrol)

HPV-test i Danmark

Region Syddanmark

Odense

Vejle

Sønderborg

Esbjerg

Har endnu ikke plan for HPV-test

HPV-test i Danmark

Region Syddanmark

Odense

- Anvender tyndtlags teknik
- DNA-test, Liniar array fra Roche og p16
- Liniar array på kvinder > 30 år med ASCUS
p16 på kvinder < 30 år med ASCUS og LSIL

HPV-test i Danmark

Region Syddanmark

Vejle

- Anvender tyndtlags teknik
- DNA-test, Liniar array fra Roche
- Liniar array på kvinder > 30 år med ASCUS

HPV-test i Danmark

Region Syddanmark

Sønderborg og Esbjerg

- Anvender tyndtlags teknik
- Anvender ikke HPV-test

HPV-test i Danmark

Region Midtjylland

Århus

Randers

Skive

Holstebro

Har endnu ikke plan for HPV-test

HPV-test i Danmark

Region Midtjylland

Århus, Randers, Skive og Holstebro

- Anvender konventionel teknik (Randers anvender både tyndtlag og konventionel)
- Ingen HPV-test , overvejer RNA-test fra NorChip (i Århus overvejes også Liniar array fra Roche og Aptima fra Gen-Probe)

HPV-test i Danmark

Region Nordjylland

Aalborg

Hjørring

Har plan for HPV-test i form af samarbejdsaftale

HPV-test i Danmark

Region Nordjylland

Aalborg og Hjørring

- Anvender konventionel teknik
- RNA-test, NorChip
- Kvinder med ASCUS og LSIL

(HPV-test udføres ved første kontrol 6 mdr efter celleforandringen)

HPV-test i Danmark

Finansiering af HPV-test

- Hillerød, DUT-midler
- Herlev, i forbindelse med aldersudvidelse i det "gamle" KBH-amt blev der tilført midler
- Roskilde, DUT-midler
- Vejle, midler fra det tidligere Vejle Amt
- Odense, søger DUT-midler
- Aalborg, kræftpuljemidler

HPV-test i Danmark

Anvendte/testede HPV-test

- Digene Hybride capture2 (HC2)
- NorChip
- Liniar array, Roche
- Aptima, Gen-Probe
- p16